

GeneXpert[®]
Powered By CEPHEID INNOVATION

Xpert[®] FFPE Lysis Kit

[REF] GXFFPE-LYSIS-CE-10

Naudojimo instrukcijos

UK **CA** **IVD** **CE**



In vitro diagnostikos medicinos priemonė

302-6233-LT, C red.
2024-04

Prekės ženklas, patentai ir autorijų teisių pareiškimai

Cepheid®, the Cepheid logo, GeneXpert®, and Xpert® are trademarks of Cepheid, registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

THE PURCHASE OF THIS PRODUCT CONVEYS TO THE BUYER THE NON-TRANSFERABLE RIGHT TO USE IT IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS FOR USE. NO OTHER RIGHTS ARE CONVEYED EXPRESSLY, BY IMPLICATION OR BY ESTOPPEL. FURTHERMORE, NO RIGHTS FOR RESALE ARE CONFERRED WITH THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.

© Cepheid, 2016–2024

„Cepheid®“, „Cepheid“ logotipas, „GeneXpert®“ ir „Xpert®“ yra „Cepheid“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai nuosavybės teise priklauso atitinkamieems turtinių teisių turėtojams.

ŠIO GAMINIO PIRKIMAS PIRKĖJUI SUTEIKIA NEPERDUODAMĄ TEISĘ JĮ NAUDOTI PAGAL ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. JOKIOS KITOS TEISĖS NĖRA PERTEIKIAMOS AIŠKIAI, NUMANOMAI ARBA ESTOPPEL. BE TO, PERKANT ŠĮ GAMINĮ NESUTEIKIAMOS JOKIOS PERPARDAVIMO TEISĖS.

© „Cepheid“, 2016–2024 m.

Pakeitimų aprašymą žr. Skirsnis 16, „Pakeitimų istorija“.

Xpert® FFPE Lysis Kit

In vitro diagnostikos medicinos priemonė

1 Numatytoji paskirtis

1.1 Numatytais naudojimas

Xpert® FFPE Lysis Kit skirtas lizuoti formalinu fiksuooto parafino įterptaji (FFPE) audinių ir išsaugoti nukleino rūgštis tolesnei GeneXpert® analizei.

1.2 Numatytais naudotojas / aplinka

Xpert FFPE Lysis Kit skirta atlikti apmokytiems naudotojams laboratorijoje.

2 Veikimo principas

FFPE audinys (iš ritinėlio ar stikelio) dedamas į mègintuvėlių kartu su rekomenduojamu FFPE lizés reagento ir proteinazės K kiekiu iš Xpert FFPE Lysis Kit. Tada mèginys maždaug 30 minučių inkubuojamas šilumos bloke 80 °C temperatūroje. Šios inkubacijos metu įvyksta tai:

1. Kaitinamas tirpalas pradeda tirpdyti parafino vašką.
2. Lizés reagentas pakeičia baltymų kryžminį ryšį, susidarantį formalino fiksavimo procedūros metu.
3. Proteinazė K virškina baltymus ir inaktyvuoja nukleazes (RNases ir DNases), kurios kitu atveju gali suardyti DNR ir RNR.

Tada etanolis ipilamas į mèginį, o rekomenduojamas paruošto mèginio lizato kiekis pridedamas tiesiai į specialią GeneXpert tyrimo kasetę.

3 Pateiktos medžiagos

Xpert FFPE Lysis Kit (1 rinkinys, užtenka 10 lizatų paruošti)

Kiekviename rinkinyje yra:

- 1 maišelis, kuriame yra 10 x 1,5 ml mègintuvėlių
- 1 maišelis, kuriame yra 10 x 5 ml buteliukų
- 1 buteliukas, kuriame yra 13 ml FFPE skysto lizés reagento
- 1 mègintuvėlis, kuriame yra 250 µl skysto proteinazės K reagento

4 Reikalingos, bet nepateikiamos medžiagos ir įranga

- Mikrotomas
- Vienkartiniai skutimosi peiliukai arba skalpelai (makrodisekcijai)
- Pipetės ir filtrių pipetės antgaliai, tinkami tiksliai perkelti 5 µl, 20 µl, 260 µl ir 600 µl
- Šilumos blokas, tinkantis laikyti 1,5 ml mikrocentrifugos mègintuvėlius (ir laikyti 80 °C temperatūroje)
- Ant stalo montuojamas sūkurinis maišytuvas
- Standartinė ant stalo montuojama mikrocentrifuga su fiksuooto kampo rotoriumi, kuriai tinka 1,5 ml mikrocentrifugos mègintuvėliai

- ≥95 % reagento klasės etanolis
- Vienkartinės pirštinės
- Lipnių etiketės arba mėginio identifikavimo informacija

5 Ispėjimai ir atsargumo priemonės

- Visiems biologiniams mėginiams reikia taikyti standartines universalias atsargumo priemones. Mėginius turėtų tvarkytik darbuotojai, apmokyti tvarkyti biologiškai pavojingas medžiagas.
- Tvardykite visus mėginio ir rinkinio reagentus naudodami atitinkamus metodus, kad išvengtumėte arba sumažintumėte užteršimą RNaze ir (arba) DNaze.
- Nenaudokite makrodisekcinių peiliukų, pipetės antgalių ar mėgintuvėlių / buteliukų, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo tvarkant mėginį.
- Išsiliejusių ar nutekėjusių reagento mėgintuvėlius reikia išmesti ir jų nenaudoti.
- Dirbdami su chemikalais ir tvarkydami biologinius mėginius laikykite savo įstaigos saugos procedūrų.
- Neužbaigus naviko ploto pašalinimo (nugramdymas) nuo stiklelio, norint paruošti FFPE lizatą, gali nepakakti medžiagos tyrimui, todėl naudojant „Xpert“ tyrimus gali būti didesnis nei tikėtasi neapibrėžtas / **NETINKAMAS (INVALID)** rodiklis.
- Norėdami gauti išsamios informacijos apie FFPE lizės rinkinio komponentų saugumą ir šalinimą, žiūrėkite Xpert FFPE Lysis Kit saugos duomenų lapą (SDL), kurį galite rasti internete adresu www.cepheidinternational.com. Atitinkama informacija iš SDL pateikiama toliau.
 - Produktu atliekos – turinį ir (arba) talpyklą (-as) šalinkite laikydamiesi vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.
 - Pakuotės atliekos – turinį ir (arba) talpyklą šalinkite laikydamiesi vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.

6 Cheminiai pavojai

Pavojingumo pareiškimai: H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo pareiškimai:

- P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones
- P302+P351+P338: PATEKUS į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Tęsti akių plovimą.
- P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

7 Reikalavimai rinkinio saugojimui

Xpert FFPE Lysis Kit turi būti laikomas 2–28 °C temperatūroje ir sunaudotas nepasibaigus galiojimo laikui (žr. išorinę rinkinio etiketę). Rinkinį galima uždaryti ir vėl atidaryti, kad būtų galima papildomai apdoroti mėginius per 8 savaites nuo pradinio atidarymo.

8 Reikalavimai FFPE mėginiams

1. Mėginiai turi būti fiksuoti tik 10 % neutraliame buferiniame formaline (NBF) 6–72 valandas, kad būtų galima ištirti bet kokiui „Xpert“ tyrimu, kuriam reikalinga RNR arba DNR iš FFPE audinio.
2. Kai kurie senesni nei 10 metų FFPE audiniai gali būti nepakankamos kokybės „GeneXpert“ analizei.
3. Patologas turi pasirinkti FFPE audinio / naviko bloką, turintį didžiausią matomo tinkamumo audinio / naviko plotą, kad būtų atliktas tyrimas.
4. „Xpert“ tyrimui apdoroti reikia nedažytų prie stiklelių pritvirtintų audinių. Jei reikalinga makrodisekcija, naudokite gretimą H&E nudažytą stiklelių iš FFPE naviko bloko, kad įsitikintumėte, jog H&E nudažytame stiklelyje nustatyta naviko sritis atitinka naviko plotą nedažytame stiklelyje.

-
5. Daugiau informacijos ieškokite „Xpert“ tyrimo pakuotės informaciniame lapelyje.


9 Stikelio / ritinėlio paruošimas

Norint paruošti FFPE audinius naudojant šį lizés rinkinį, reikia apdoroti ant nedažto (-ų) stikelio (-ių) uždėtą (-as) mèginio sekciją (-as) arba ritinėlį (-ius) ir gretimą H&E nudažytą stiklelių iš to paties audinio bloko.

1. Mikrotomu nupjaukite 4–5 µm storio atkarpatą H&E dažymui.
2. Iškirpkite gretimą 4–5 µm storio sekciją arba ritinėlį, kad galėtumėte naudoti FFPE lizés rinkinyje.
 - Mèginiams, kuriems reikia kelių stiklelių / ritinėlių, kad atitiktų minimalius „Xpert“ tyrimo reikalavimus, visi stikleliai / ritinėliai turi būti apdorojami kartu.
3. Norédami paruošti audinio sekciją (-as), laikykites standartinių histologijos metodų.
 - Įsitikinkite, kad audinių sekcijos yra visiškai sausos.
 - FFPE lizei skirtą stikelio sekciją (-as) reikia laikyti 2–8 °C temperatūroje ir apdoroti per dvi savaites po paruošimo; tačiau šviežiai nupjautos sekcijos duos aukščiausios kokybės ir patikimiausius rezultatus, nes mRNA skaidosi greičiau stikelio sekcijose, veikiamose oro, nei FFPE blokuose.
4. Norédami paruošti audinių ritinėlį (-ius), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - Įdékite ritinėlį (-ius) į pateiktą 1,5 ml lizés mègintuvėlį. Pažymėkite kiekvieno apdoroto mèginio mègintuvėlį.
 - Ritinėlis (-iai) 1,5 ml mègintuvėlyje turi būti laikomi 2 °C–8 °C temperatūroje ir apdoroti per 2 savaites po paruošimo.

10 Audinio pašalinimas nuo stikelio

1. Pažymėkite 1,5 ml lizés mègintuvėlį (pridedamas) kiekvienam apdorotam mèginui.
2. Jei makrodisekcija nereikalinga:
 - a. Naudodami naują skutimosi peiliuką arba skalpelį kiekvienam apdorojamam audinio mèginui, visiškai pašalinkite (nugramdykite) visą audinio sekciją nuo stikelio ir perkeltite į pažymėtą 1,5 ml lizés mègintuvėlį.
 - b. Sekcija (-os) 1,5 ml mègintuvėlyje turi būti laikomos 2 °C–8 °C temperatūroje ir apdorotos per 2 savaites.
3. Jei reikalinga makrodisekcija:
 - a. Ištirkite H&E nudažytą stiklelių (patologas). Nustatykite (ir nubrèžkite) naviko plotą tyrimui. Informaciją apie reikiamą stikelio skaičių arba minimalų naviko lasteliškumą žr. „Xpert“ tyrimo pakuotės informaciniame lapelyje.
 - b. Pasiruoškite makrodisekcijai (patologas). Nedažto (-ų) stikelio (-ių) galinėje pusėje nubrèžkite naviko plotą, kuris bus naudojamas tyrimui, suderindami ji su attinkamu H&E dažytu stikleliu ir perkeldami kontūro sritį.
 - c. Atlikite makrodisekciją (patologas arba technikas). Naudodami naują skutimosi peiliuką arba skalpelį kiekvienam apdorojamam naviko mèginui, visiškai pašalinkite (nugramdykite) nuo stikelio nubraižytą invazinį naviko audinį (žr. 1 pav.) ir perkeltite į pažymėtą 1,5 ml lizés mègintuvėlį.
 - d. 1,5 ml mègintuvėlyje makrodisekcijos būdu gautą (-as) sekciją (-as) reikia laikyti 2–8 °C temperatūroje ir apdoroti per 2 savaites.

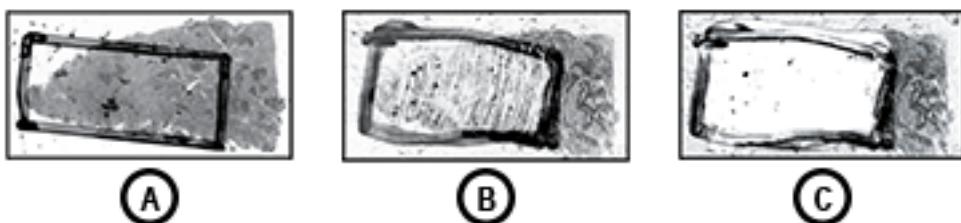

pav. 1. Tinkamo (rekomenduojama) ir netinkamo (nerekomenduojama) audinių pašalinimo nuo stiklelio pavyzdžiai

A	Žiūrėkite H&E dažytą stiklelj
B	Nerekomenduojama (pašalinta nepakankamai audinio)
C	Rekomenduojama

11 FFPE audinių apdorojimas

- Į mēgintuvėlį, kuriamo yra FFPE mèginys, įpilkite 1200 µl (1,2 ml) FFPE lizés reagento ir 20 µl proteinazés K, tada uždarykite dangtelį.
- Maišykite mèginį mažiausiai 10 sekundžių, tada trumpai pasukite mèginį (kad pašalintumėte skystį nuo dangtelio).
- Mèginį inkubuokite mažiausiai 30 minučių šilumos bloke, pašildytame iki 80 °C.
- Po inkubacijos 80 °C temperatūroje maišykite mèginį mažiausiai 10 sekundžių, tada trumpai pasukite mèginį.
- Pipete perkelykite visą mèginį (~1,2 ml) į pažymétą 5 ml mèginio buteliuką.
- Į mèginį įpilkite 1200 µl >95 % etanolio ir uždarykite dangtelį.
- Maišykite mèginį mažiausiai 15 sekundžių.

12 FFPE audinių apdorojimas – koncentruotas lizatas

Laikykites šio protokolo, jei dėl nepakankamo mèginio reikia labiau koncentruoto lizato (tai turėtų būti svarstoma esant $\leq 6 \times 1 \text{ mm}^2$ naviko plotui ant nugramdyto stiklelio). Daugiau informacijos rasite „Xpert“ tyrimo pakuočės informaciniame lapelyje.

- Į pažymétą 1,5 ml mēgintuvėlį, kuriamo yra FFPE mèginys, įpilkite 260 µl FFPE lizés reagento ir 5 µl proteinazés K, tada uždarykite dangtelį.
- Maišykite mèginį mažiausiai 10 sekundžių, tada trumpai pasukite mèginį (kad pašalintumėte skystį nuo dangtelio).
- Mèginį inkubuokite mažiausiai 30 minučių šilumos bloke, pašildytame iki 80 °C.
- Po inkubacijos 80 °C temperatūroje maišykite mèginį mažiausiai 10 sekundžių, tada trumpai pasukite mèginį.
- Į tą patį 1,5 ml lizés mēgintuvėlį įpilkite 260 µl $\geq 95\%$ etanolio ir uždarykite dangtelį.
- Maišykite mèginį mažiausiai 10 sekundžių, tada trumpai pasukite mèginį.

13 Mèginio laikymas ir transportavimas

Paruoštas lizatas su etanoliu turi būti gabenamas į laboratoriją 2–8 °C temperatūroje, jei tyrimas turi būti atliktas per 1 savaitę. Jei tyrimas turi būti atliktas vėliau, FFPE lizatas yra stabilus ir gali būti laikomas iki 4 savaičių ≤ -20 °C temperatūroje prieš tyrimą.

14 Techninė pagalba

Prieš susisiekdamis su mumis

Prieš susisiekdamis su „Cepheid“ techninė pagalba, surinkite šią informaciją:

- Produkto pavadinimas
- Partijos numeris

Techninė pagalba Jungtinėse Amerikos Valstijose

Telefonas: + 1 888 838 3222 El. paštas: techsupport@cepheid.com

Techninė pagalba Prancūzijoje

Telefonas: + 33 563 825 319 El. paštas: support@cepheideurope.com

Visų „Cepheid“ techninės pagalbos padalinių kontaktinę informaciją galima rasti mūsų svetainėje: www.cepheid.com/en/support/contact-us.

Praneškite apie rimbust su produkta susijusius incidentus „Cepheid“ ir valstybės narės, kurioje įvyko rimtas incidentas, kompetentingai institucijai.

15 Simbolių lentelė

Simbolis	Reikšmė
	Katalogo numeris
	CE ženklas – Europos atitiktis
	Jungtinės Karalystės atitikties įvertinimas
	Pakanka n tyrimams vykdyti
	Gamintojas
	Gaminimo šalis
	Temperatūros apribojimas
	Siuntos kodas
	Žiūrėti naudojimo instrukciją
	Biologinė rizika
	<i>In vitro</i> diagnostikos medicinos priemonė
	Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	Jungtinės Karalystės atsakingas asmuo
	Igaliotasis atstovas Šveicarijoje
	Nenaudoti pakartotinai
	Dėmesio
	Atsargiai
	Galiojimo pabaigos data
	Importuotojas



Cepheid
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089
USA

Telefonas: + 1 408 541 4191

Faksas: + 1 408 541 4192

EC **REP**

Cepheid Europe SAS
Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont
France

Telefonas: + 33 563 825 300

Faksas: + 33 563 825 301

UK **REP**

Cepheid UK Limited
Oakley Court, Kingsmead Business Park
Frederick Place, High Wycombe
HP11 1JU, United Kingdom

CH **REP**

Cepheid Switzerland GmbH
Zürcherstrasse 66
Postfach 124, Thalwil
CH-8800
Switzerland



Cepheid AB
Röntgenvägen 5
SE-171 54 Solna
Sweden

Cepheid Switzerland GmbH
Zürcherstrasse 66
Postfach 124, Thalwil
CH-8800
Switzerland

UK
CA

IVD

CE

16 Pakeitimų istorija

Pakeitimų aprašymas: 302-6233 B red. į C red.

Tikslas: Atnaujintas importuotojo į ES adresas.

Skyrius	Pakeitimimo aprašymas
Simbolių lentelė	Atnaujintas importuotojo į ES adresas.
Pakeitimų istorija	Atnaujintas skyrius „Pakeitimų istorija“.